

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Aa.

- AEROMETRO (HIDROMETRO) BAUME 0 - 50, (15 °C)
- AEROMETRO (HIDROMETRO) BAUME 0 - 70, (15 °C)
- ALCOHOLIMETRO 0 - 100 CON TERMOMETRO
- ALCOHOLIMETRO 0 - 100 SIN TERMOMETRO
- ASA EN FERRONIQUEL PUNTA RECTA DELGADA
- ASA EN FERRONIQUEL PUNTA RECTA GRUESA
- ASA EN FERRONIQUEL PUNTA REDONDA.
- ASAS POLIESTIRENO ESTERIL AZULES 10 uL
- ASAS POLIESTIRENO ESTERIL AZULES 10 uL
- ASAS POLIESTIRENO ESTERIL BLANCAS 1 uL

PRESENT	MARCA
1.0 UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	NACIONAL
1.0UD	NACIONAL
1.0UD	NACIONAL
20.0xPQ	KARTELL
2000.0 xPQ	KARTELL
20.0xPQ	KARTELL

Bb.

- BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 100 ml
- BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 100 ml
- BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 250 ml
- BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 500 ml
- BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 500 ml.
- BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 5 mL
- BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 10 mL
- BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 10 mL

1.0 UD	SIMAX (ALE)
1.0UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	SIMAX (ALE)
1.0UD	BOECO
1.0 UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	LABGILLS (ESP)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Bb.

	PRESENT	MARCA
• BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 20 mL	1.0 UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 20 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 25 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 25 mL	1.0UD	TGI(ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 50 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 50 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 100 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 100 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 200 mL	1.0 UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 200 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 250 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 250 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Bb.

	PRESENT	MARCA
• BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 250 mL	1.0 UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 500 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 500 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 1000 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 1000 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 2000 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 2000 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 10 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 10 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 20 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 20 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 25 mL	1.0 UD	LMS (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Bb.

	PRESENT	MARCA
• BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 25 mL	1.0 UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 50 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 50 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 100 ml	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 100 ml	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 100 ml	1.0UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 200 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 250 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 250 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 500 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 1000 ml	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 1000 ml	1.0 UD	LMS (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Bb.

	PRESENT	MARCA
• BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 2000 mL	1.0 UD	LMS (ALE)
• BALONVOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 2000 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR CON TAPON, CLASE A, DE 2000 mL	1.0UD	GLASSCO
• BALON VOLUMETRICO PLASTICO PMP AUTOCLAVABLE TAPON EN TEFLON 50mL	1.0UD	KARTELL
• BALON VOLUMETRICO PLASTICO PMP AUTOCLAVABLE TAPON EN TEFLON 100mL	1.0UD	KARTELL
• BALON VOLUMETRICO PLASTICO PMP AUTOCLAVABLE TAPON EN TEFLON 250mL	1.0UD	KARTELL
• BANDEJA PARA LAMINAS PORTAOBJETO 76X26mm, 20 CAVIDADES	1.0UD	KARTELL
• BARRA MAGNETICA DE 20 X 6 mm EN TEFLON	1.0UD	BOECO
• BARRA MAGNETICA DE 25 X 6 mm EN TEFLON	1.0UD	BOECO
• BARRA MAGNETICA DE 30 X 7 mm EN TEFLON	1.0UD	BOECO
• BARRA MAGNETICA DE 40 X 8 mm EN TEFLON	1.0UD	KARTELL
• BARRA MAGNETICA RECOGEIMANES, DE 30 cm TEFLON	1.0UD	KARTELL
• BARRA MAGNETICA RECOGEIMANES, DE 35 cm TEFLON	1.0UD	BOECO
• BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE4 oz (120 mL)	500.0xCJ	NASCO (USA)
• BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE 18 oz (540 mL)	500.0xCJ	NASCO (USA)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO




Bb.

	PRESENT	MARCA
• BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE 100 mL CON TIOSULFATO	100.0 xCJ	NASCO (USA)
• BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE 300 mL CON TIOSULFATO	100.0xCJ	NASCO (USA)
• BOTELLA PARA PETROLEO OVALADA VIDRIO CLARO CON GRADUACION 6 OZ.	48.0xCJ	QORPAK
• BOTELLA PARA PETROLEO OVALADA VIDRIO CLARO CON GRADUACION 6 OZ.	1.0UD	QORPAK
• BURETACLASE B LLAVE DE VIDRIO DE 10 mL (0.05)	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE B LLAVE DE VIDRIO DE 25 mL (0.10)	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE B LLAVE DE VIDRIO DE 50 mL (0.10)	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE B. LLAVE DE TEFLON DE 10 mL (0.05)	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE B. LLAVE DE TEFLON DE 25 mL (0.05)	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE B. LLAVE DE TEFLON DE 50 mL (0.10)	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE A LLAVE DE VIDRIO DE 10 ml (0.05) CERTIFICADO POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE A LLAVE DE VIDRIO DE 25 ml (0.05) CERTIFICADO POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE A LLAVE DE VIDRIO DE 50 ml (0.1) CERTIFICADO POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• BURETA CLASE A. LLAVE DE TEFLON DE 10 ml (0.05) CERTIFICADO POR LOTE	1.0 UD	LMS (ALE)
• BURETACLASE A. LLAVE DE TEFLON DE 25 ml (0.05) CERTIFICADO POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

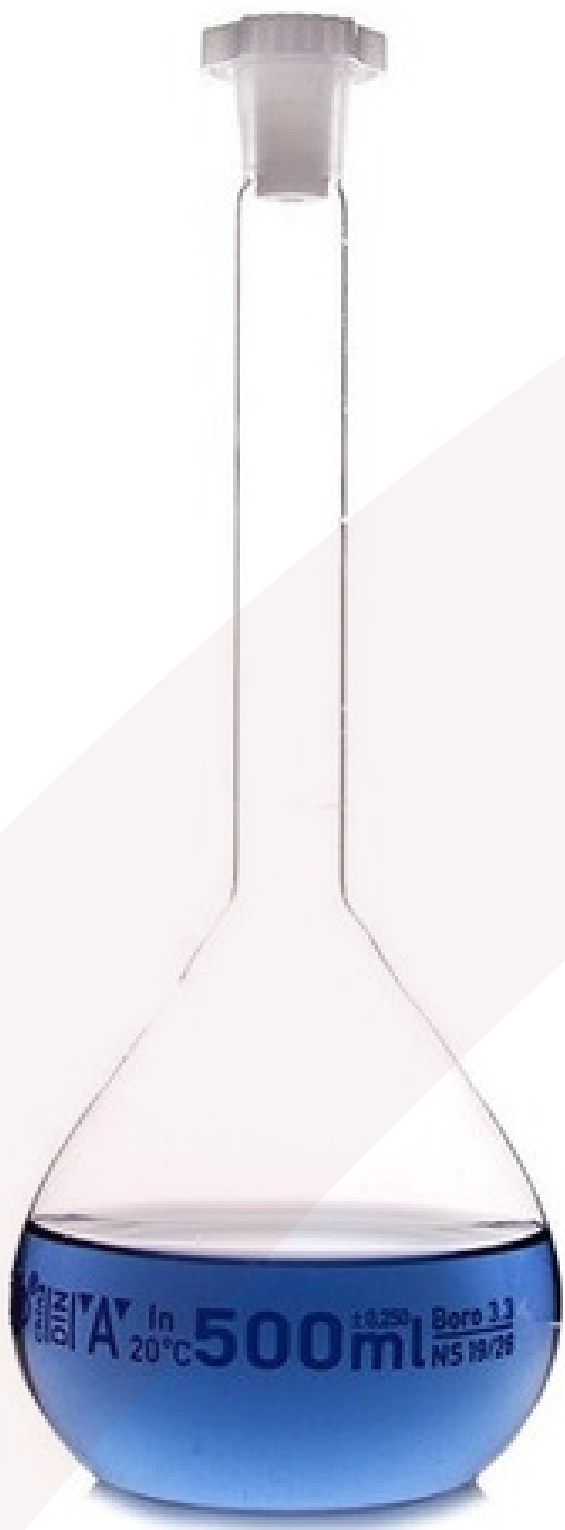

Bb.

	PRESENT	MARCA
• BURETA CLASE A. LLAVE DE TEFLON DE 50 ml (0.10)	1.0 UD	1.0 UD
• BURETA CLASE A. VIDRIO AMBAR. LLAVE DE TEFLON DE 25 ml (0.05)	1.0UD	1.0UD
• BURETA AUTOMATICA VIDRIO CLARO, CLASE A, LLAVE TEFLON, SIN FRASCO, SIN PERA, DE 50 mL (0.1) CON CERT	1.0UD	1.0UD
• BURETA DIGITAL 0-50 mL	1.0UD	1.0UD
• BUTIROMETRO PARA LECHE DE 0-7%	1.0UD	1.0UD
• BUTIROMETRO PARA LECHE DE 0-8%	1.0UD	1.0UD

Cc.

• CAJA PETRI PLASTICA ESTERIL DESECHABLE 94 X 16 mm	480.0 xCJ	BOECO
• CAJA PETRI VIDRIO DE 60 X 15 mm	1.0UD	PETRIQ
• CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 mm	1.0UD	PETRIQ
• CAJA PLASTICA PARA 25 LAMINAS PORTAOBJETOS DE 3 X 1'	1.0UD	KARTELL
• CAJA PLASTICA PARA 50 LAMINAS PORTAOBJETOS DE 3 X 1'	1.0UD	KARTELL
• CAJA PLASTICA PARA 100 LAMINAS PORTAOBJETOS DE 3 X 1'	1.0UD	KARTELL
• CAMARA DE NEWBAUER	1.0UD	BOECO
• CAMARA DE NEWBAUER LINEA BRILLANTE	1.0UD	BOECO

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Cc.

PRESENT MARCA

- | | | |
|--|---------|------------|
| • CAMARA DE VIDRIO CON TAPA, PARA CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA, PARA PLACA DE 10 X 10 cm | 1.0 UD | FUNGILAB |
| • CAMARA DE VIDRIO CON TAPA, PARA CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA, PARA PLACA DE 20 X 20 cm | 1.0UD | FUNGILAB |
| • CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE63 mm ø | 1.0UD | HLW |
| • CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE70 mm ø | 1.0UD | HLW |
| • CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE80 mm ø | 1.0UD | HLW |
| • CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 83 mm ø | 1.0UD | JIPO (ALE) |
| • CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 96 mm ø | 1.0UD | JIPO (ALE) |
| • CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 100 mm ø | 1.0UD | HLW |
| • CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 112 mm ø | 1.0UD | JIPO (ALE) |
| • CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 132 mm ø | 1.0UD | JIPO (ALE) |
| • CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 25X60 mm | 25.0xCJ | M.F.S. |
| • CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 25X80 mm | 25.0xCJ | M.F.S. |
| • CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 25X80 mm. | 25.0xCJ | BOECO |
| • CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 26X60 mm | 25.0xCJ | BOECO |

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Cc.

	PRESENT	MARCA
• CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 26X60 mm	25.0 xCJ	CHM (ESP)
• CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 33 X 80 mm	25.0xCJ	M.F.S.
• CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 33 X 80 mm.	25.0xCJ	CHM (ESP)
• CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 33X 94 mm.	25.0xCJ	BOECO
• CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 33X 94 mm.	25.0xCJ	CHM (ESP)
• CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 33X100 mm	25.0xCJ	M.F.S.
• CELDA TURBIDIMETRO, VER EQUIPOS: TURBIDIMETRO-ACCESORIO	1.0UD	BOECO
• CELDAS DE CUARZO 45 X 12.5 mm, 10 mm DE PASO, CON TAPA, 190 - 2500 nm.	1.0 UD	BOECO
• CELDAS DE VIDRIO OPTICO 45 X 12.5 mm, 10 mm DE PASO, CON TAPA, 3.5 ml	1.0UD	NSG (USA)
• CELDAS DE VIDRIO OPTICO 45 X 12.5 mm, 10 mm DE PASO, CON TAPA, 3.5 ml	1.0UD	FISHER
• CELDAS DE VIDRIO PARA FOTOMETRO, DE 10 mm ø		
• CELDAS POLIESTIRENO 4,5 ml, PARA ESPECTROFOTOMETRO	100.0xCJ	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO




Cc.

	PRESENT	MARCA
• CHUPAS DE GOMA PARA PIPETA PASTEUR O FRASCO GOTERO	1.0 UD	KARTELL
• CHURRUSCO (JUEGO)	16.0xPQ	NACIONAL
• CINTA INDICADORA DE ESTERILIDAD 50 mts X 19 mm	1.0UD	KARTELL
• CINTA PARA MEDIR, 8 METROS SIN CERTIFICAR REF.CN1290SME CON PLOMADA REF.590GME	1.0UD	LUFKIN
• CINTA PARA MEDIR, 15 METROS REF.CN1293SME SIN PLOMADA, VER REFERENCIA 590GME PARA LA PLOMADA	1.0UD	LUFKIN
• CINTA PARA MEDIR, 15 METROS SIN CERTIFICAR REF.CN1293SME CON PLOMADA REF.590GME	1.0UD	LUFKIN
• COLUMNA CROMATOGRAFICA FASE ESTACIONARIA: C18-5, 4.6 mm X 15cm, 5 µm, PARA DETERMINACION DE CONSERVANTES POR HPLC	1.0UD	SUPELCO
• CONO DE SEDIMENTACION IMHOFF DE 1000 ml	1.0UD	KARTELL
• CRISOL - ACCESORIO: TAPA PARA CRISOL DE 49 MM	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL - ACCESORIO: TAPA PARA CRISOL DE 54 MM	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMAALTA, SIN TAPA, DE 30X38 mm (15 mL)	1.0UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMAALTA, SIN TAPA, DE 35X44 mm (24 mL)	1.0UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMAALTA, SIN TAPA, DE 46X53 mm (50 mL)	1.0UD	HLW

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

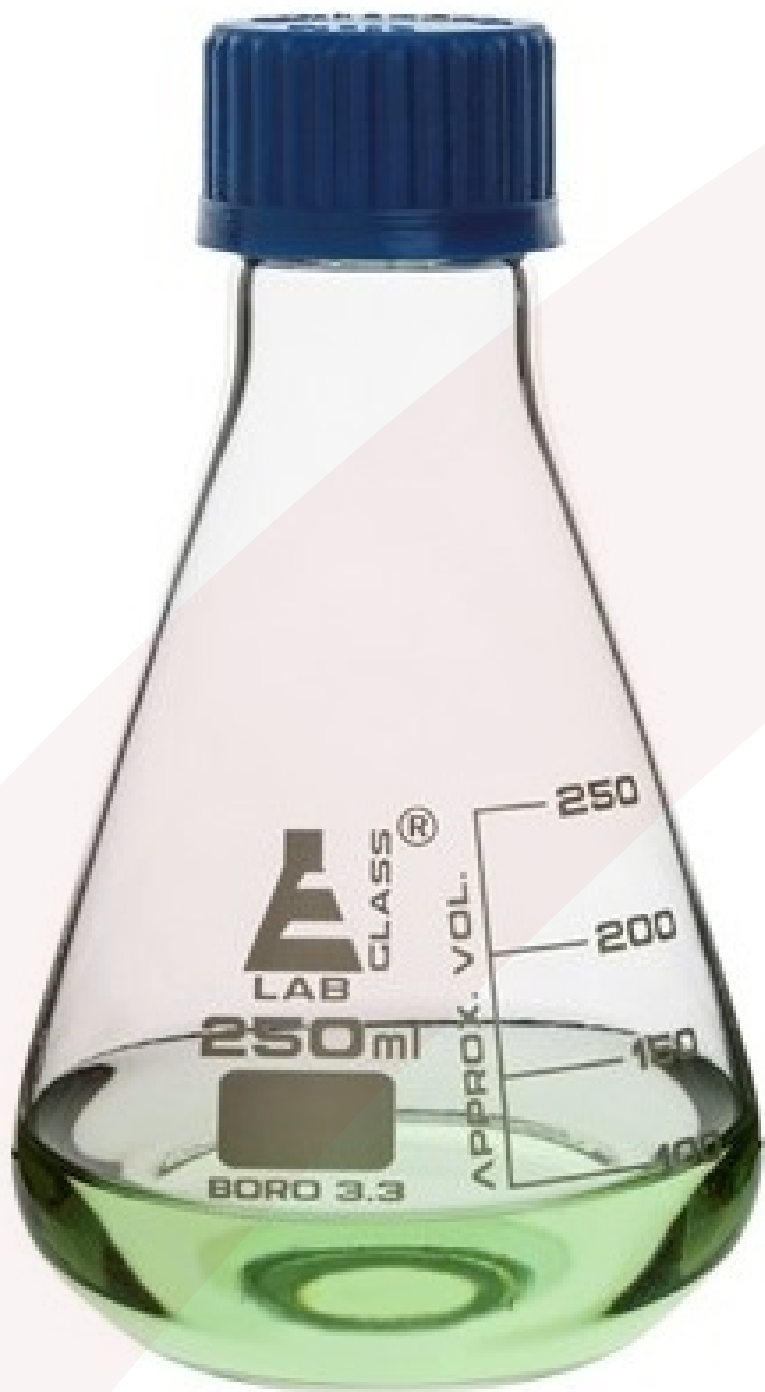

Cc.

	PRESENT	MARCA
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA ALTA, SIN TAPA, DE 35X44 mm (26 mL)	1.0 UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA ALTA, SIN TAPA, DE 45X56 mm (50 mL)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 40X32 mm (20 mL)	1.0UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 45X36 mm (38 mL)	1.0UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 50X40 mm (50 mL)	1.0UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 63X55 mm (110 mL)	1.0UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 35X28 mm (12 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 40X32 mm (20 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 45X36 mm (30 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 50X40 mm (45 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 60X48 mm (80 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA BAJA, SIN TAPA, DE 40X26 mm (20 mL)	1.0UD	HLW

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Cc.

	PRESENT	MARCA
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA BAJA, SIN TAPA, DE 45X29 mm (25 mL)	1.0 UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA BAJA, SIN TAPA, DE 50X32 mm (40 mL)	1.0UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA BAJA, SIN TAPA, DE 60X38 mm (65 mL)	1.0UD	HLW
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA BAJA, SIN TAPA, DE 45X25 mm (17 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL EN PORCELANA, FORMA BAJA, SIN TAPA, DE 50X32 mm (29 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL GOOCH EN PORCELANA, DE 35X41 mm (25 ml)	1.0UD	HLW
• CRISOL GOOCH EN PORCELANA, DE 35X43 mm (25 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRISOL GOOCH EN PORCELANA, DE 39X49 mm (35 ml)	1.0UD	JIPO (ALE)
• CRONOMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO DE 99 MINUTOS	1.0 UD	CASIO
• CUBETA EN PLASTICO (PMP) PARA COLORACION CON DOBLE TAPA. INCLUYE CESTILLO CON ASA PARA 20 PORTAOBJET	1.0UD	KARTELL
• CUBETA EN PLASTICO (PMP) PARA COLORACION DE 16 PORTAOBJETOS	1.0UD	KARTELL
• CUBETA EN VIDRIO PARA COLORACION, DE 16 PORTAOBJETOS (105 mm)	1.0UD	BOECO
• CUCHARA DE MEDICION EN PP. DE 10 ml	1.0UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Dd.


	PRESENT	MARCA
• DENSIMETRO DE 700 - 1000 (0.005) 32 cm	1.0 UD	BOECO
• DENSIMETRO DE 1000 - 1500 (0.005) 28 cm	1.0UD	BOECO
• DESECADOR - ACCESORIO: LLAVE EN VIDRIO PARA VACIO	1.0UD	KAVALIER
• DESECADOR - ACCESORIO: PLACA DE 150 mm EN ACERO INOXIDABLE	1.0UD	E&Q
• DESECADOR - ACCESORIO: PLACA DE 250 mm EN ACERO INOXIDABLE	1.0UD	E&Q
• DESECADOR - ACCESORIO: PLACA DE 250 mm EN PORCELANA	1.0UD	IMPORTADO
• DESECADOR - ACCESORIO: PLACA DE 300 mm EN ACERO INOXIDABLE	1.0UD	E&Q
• DESECADOR - ACCESORIO: PLACA DE 300 mm EN PORCELANA	1.0UD	JIPO (ALE)
• DESECADOR - ACCESORIO: TAPA CON LLAVE DE 250 mm	1.0UD	SIMAX (ALE)
• DESECADOR - ACCESORIO: TAPA SIN LLAVE DE 250 mm	1.0UD	SIMAX (ALE)
• DESECADOR - ACCESORIO: TAPA SIN LLAVE DE 300 mm	1.0UD	SIMAX (ALE)
• DESECADOR EN VIDRIO, SIN LLAVE DE VACIO, CON PLACA DE 150 mm	1.0UD	SIMAX (ALE)
• DESECADOR EN VIDRIO, SIN LLAVE DE VACIO, CON PLACA DE 250 mm	1.0UD	SIMAX (ALE)
• DESECADOR EN VIDRIO, SIN LLAVE DE VACIO, CON PLACA DE 300 mm	1.0UD	SIMAX (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

Dd.

	PRESENT	MARCA
• DESECADOR EN VIDRIO, CON LLAVE DE VACIO, CON PLACA DE 150 mm	1.0 UD	SIMAX (ALE)
• DESECADOR EN VIDRIO, CON LLAVE DE VACIO, CON PLACA DE 250 mm	1.0UD	SIMAX (ALE)
• DESECADOR EN VIDRIO, CON LLAVE DE VACIO, CON PLACA DE 300 mm	1.0UD	SIMAX (ALE)
• DESECADOR PLASTICO, TAPA PC Y BASE PP, CON LLAVE DE VACIO, SIN PLACA DE 200 mm	1.0UD	KARTELL
• DESECADOR PLASTICO, TAPA PC Y BASE PP, CON LLAVE DE VACIO, SIN PLACA DE 250 mm	1.0UD	KARTELL
• DESECADOR PLASTICO-ACCESORIO: EMPAQUE PARA DESECADOR REF.554	1.0UD	KARTELL
• DESECADOR PLASTICO-ACCESORIO: LLAVE PARA VACIO DE DESECADOR	1.0xPQ	KARTELL
• DESECADOR PLASTICO-ACCESORIO: PLACA EN PP DE 200 mm	1.0UD	KARTELL
• DESECADOR PLASTICO-ACCESORIO: PLACA EN PP DE 250 mm	1.0UD	KARTELL
• DESTILADOR: VER LISTA EQUIPOS IMPORTADOS	1.0UD	
• DISCO DE JERINGA DE NITRATO DE CELULOSA DE 0.45 MICRAS 25mm	50.0xCJ	M.F.S.
• DISPENSADOR DE VOLUMEN VARIABLE DE 0,2 -2,5 mL (0.2)	1.0UD	POBEL

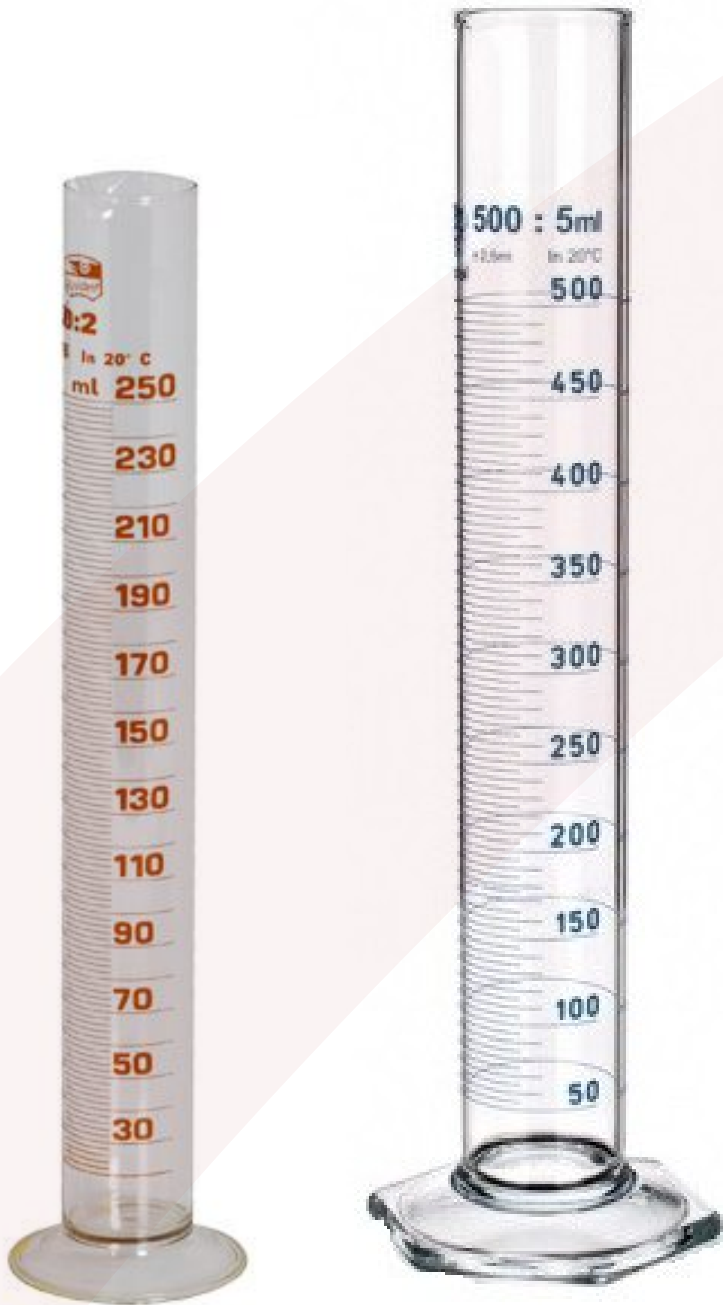

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Dd.


	PRESENT	MARCA
• DISPENSADOR DE VOLUMEN VARIABLE DE 1 - 10 mL (0.2)	1.0 UD	LABGILLS (ESP)
• DISPENSADOR DE VOLUMEN VARIABLE DE 2,5 - 30 mL (0.5)	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• DISPENSADOR DE VOLUMEN VARIABLE DE 2,5 - 30 mL (0.5)	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• DISPENSADOR DE VOLUMEN VARIABLE DE 5 - 60 mL (1)	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• DISPENSADOR DE VOLUMEN VARIABLE DE.10 - 100 mL (2.0)	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• DISPENSADOR PARA 50 LAMINAS PORTAOBJETOS DE 3 X 1'	1.0UD	KARTELL

Ee.

• EMBUDO PLASTICO ESTRIADO (PP) 80 mm ø	1.0 UD	KARTELL
• EMBUDOPLASTICO ESTRIADO (PP) 100mm ø	1.0UD	KARTELL
• EMBUDO BUCHNER PLASTICO EN PP, DE 42,5 mm ø, DE 2 PIEZAS (40 ml)	1.0UD	KARTELL
• EMBUDO BUCHNER PLASTICO EN PP, DE 80 mm ø, DE 2 PIEZAS (285 ml)	1.0 UD	KARTELL
• EMBUDO BUCHNER PLASTICO EN PP, DE 90 mm ø, DE 2 PIEZAS (390 ml)	1.0UD	KARTELL
• EMBUDO BUCHNER PORCELANA DE 100 mm, PORO 1.5 mm (240 mL)	1.0UD	JIPO (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

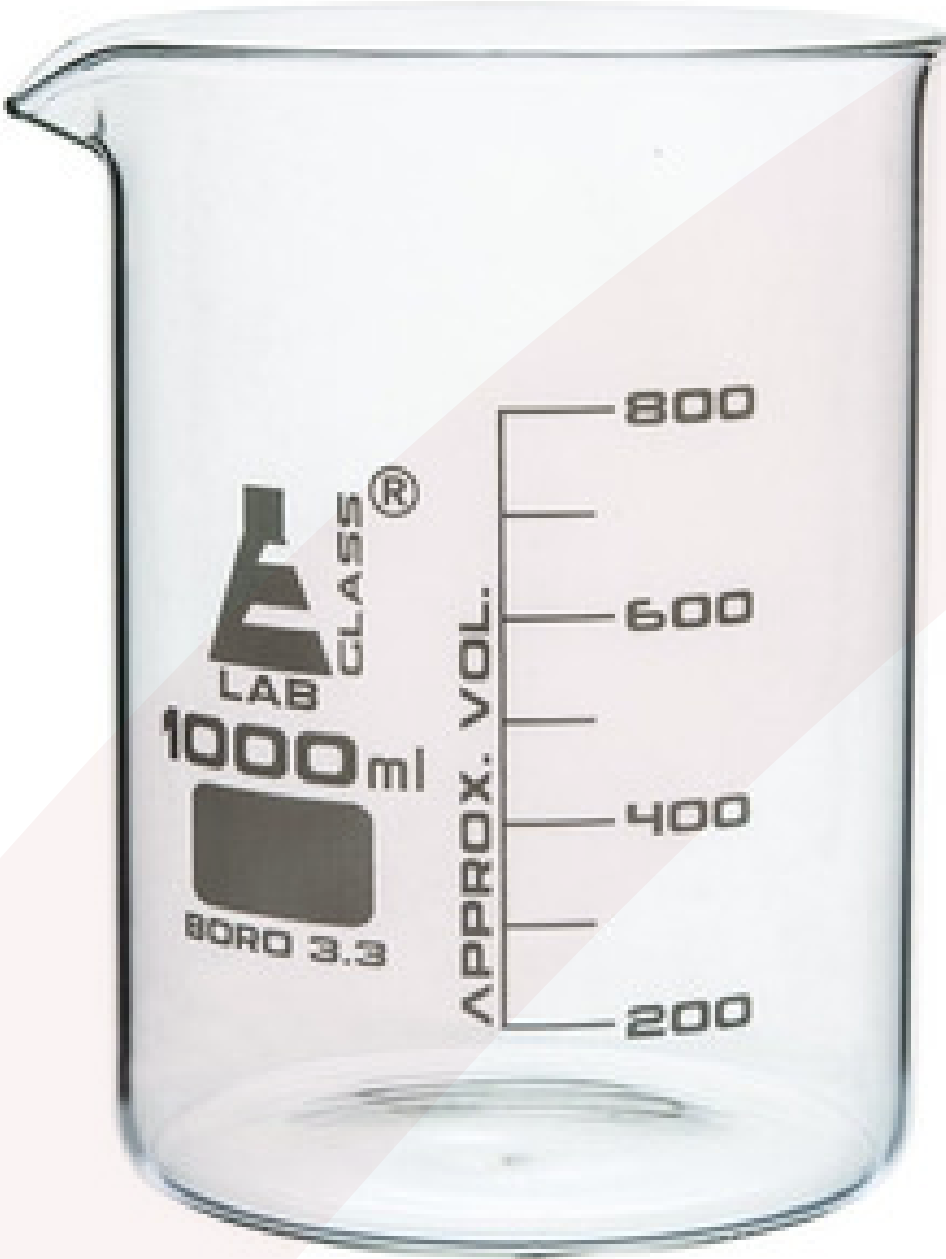

Ee.

	PRESENT	MARCA
• EMBUDO BUCHNER PORCELANA DE 124 mm, PORO 1.5 mm (400 mL)	1.0 UD	JIPO (ALE)
• EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO 100 ml, GRADUADO, LLAVE TEFLON	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO 250 ml, GRADUADO, LLAVE TEFLON	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO 500 ml,SIN GRADUAR, LLAVE VIDRIO	1.0UD	TGI(ALE)
• EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO 500 ml, GRADUADO, LLAVE TEFLON	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO 1000 ml, GRADUADO, LLAVE TEFLON	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO 2000 ml, GRADUADO, LLAVE TEFLON	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO EN VIDRIO, VASTAGO CORTO, DE 70 mm ø	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO EN VIDRIO, VASTAGO CORTO, DE 100 mm ø	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO EN VIDRIO, VASTAGO LARGO, DE 70 mm ø	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO EN VIDRIO, VASTAGO LARGO, DE 100 mm ø	1.0UD	LMS (ALE)
• EMBUDO GOOCH EN VIDRIO DE 30 ml	1.0UD	GLASSCO
• EMBUDO PARA FILTRACION DE MEMBRANA 47 mm, EN VIDRIO DURAN	1.0UD	NACIONAL
• EMBUDO PARA FILTRACION DE MEMBRANA, POLISULFONA, UNAPLAZA, 300 mL	1.0UD	M.F.S.

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Ee.

	PRESENT	MARCA
• EQUIPO PARA FILTRACION DE MEMBRANA, EN POLISULFONA, DE 300mL, 1 PUESTO	1.0 UD	M.F.S.
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 50 ml	1.0UD	SIMAX (ALE)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 50 ml.	1.0UD	POBEL
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 100 mL	1.0UD	BOECO
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 100 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 125 mL	1.0UD	KIMAX
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 250 ml	1.0UD	BOECO
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 250 ml	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 500 ml	1.0UD	BOECO
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 500 ml	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 1000 ml	1.0UD	SIMAX (ALE)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 1000 mL	1.0UD	BOECO
• ERLLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 2000 ml	1.0UD	SIMAX (ALE)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 250mL	1.0UD	BOECO
• ERLLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 250ml.	1.0UD	POBEL
• ERLLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 500 mL	1.0UD	BOECO
• ERLLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 500 mL.	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 1000 ml	1.0UD	SCHOTT
• ERLLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 1000 ml.	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 2000 ml	1.0UD	SIMAX (ALE)
• ERLLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO DE 2000 ml	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• ERLLENMEYER PLASTICO PP BOCA ANGOSTA, 125 ml, GRADUADO, AUTOCLAVABLE	1.0UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Ee.

	PRESENT	MARCA
• ERLLENMEYER PLASTICO PP BOCA ANGOSTA, 250 ml, GRADUADO, AUTOCLAVABLE	1.0 UD	KARTELL
• ERLLENMEYER PLASTICO PP BOCA ANGOSTA, 500 ml, GRADUADO, AUTOCLAVABLE	1.0UD	KARTELL
• ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO PLASTICO DE 12 cm DE LONGITUD	1.0UD	NACIONAL
• ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE,DOBLE (ESPATULA - CANAL) DE 185 X 9 mm	1.0UD	BOECO
• ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE,DOBLE (ESPATULA - CUCHARA) DE 180 X 29 mm	1.0UD	BOECO
• ESPATULA PLASTICA DOBLE (ESPATULA-CUCHARA) DE 180 mm, RESISTENTE, AUTOCLAVABLE	1.0UD	KARTELL
• ESPATULA PLASTICA DOBLE (ESPATULA-ESPATULA) DE 180 mm, RESISTENTE, AUTOCLAVABLE	1.0UD	KARTELL

Ff.

• FILTRO CUALITATIVO MEDIO CORRUGADO DE 58 X 58 cm	100.0 xPQ	BOECO
• FILTRO CUALITATIVO MEDIO CORRUGADO DE 58 X 58 cm	1.0UD	BOECO
• FILTRO CUALITATIVO MEDIO DE 70 mm ø	100.0xCJ	BOECO
• FILTRO CUALITATIVO MEDIO DE 90 mm ø	100.0xCJ	BOECO
• FILTRO CUALITATIVO MEDIO DE 110 mm ø	100.0xCJ	BOECO

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Ff.

- FILTRO CUALITATIVO MEDIO DE 125 mm ø
- FILTRO CUALITATIVO MEDIO DE 150 mm ø
- FILTRO CUALITATIVO MEDIO DE 185 mm ø
- FILTRO CUALITATIVO MEDIO DE 185 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA AZUL DE 110 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA AZUL DE 125 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA BLANCA DE 110 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA BLANCA DE 125 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA BLANCA DE 150 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA BLANCA DE 150 mm ø.
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA NEGRA DE 125 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA NEGRA DE 150 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA NEGRA DE 150 mm ø
- FILTRO CUANTITATIVO BANDA ROJA DE 125 mm ø
- FILTRO FIBRA DE VIDRIO GA55 DE 8 X 10' PARA AIRE
- FILTRO FIBRA DE VIDRIO GC50 DE 24 mm ø
- FILTRO FIBRA DE VIDRIO GC50 DE 47 mm ø
- FILTRO FIBRA DE VIDRIO GC50 DE 47 mm ø.
- FILTRO FIBRA DE VIDRIO GC50 DE 55 mm ø.
- FILTRO FIBRA DE VIDRIO GC50 DE 90 mm ø.
- FILTRO FIBRA DE VIDRIO GC50 DE 110 mm ø
- FILTRO FIBRA DE VIDRIO GC50 DE 110 mm ø.
- FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO DE 500 ml
- FRASCO GOTERO PLASTICO DE 50 mL

PRESENT	MARCA
100.0 xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	CHM (ESP)
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	CHM (ESP)
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	CHM (ESP)
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	CHM (ESP)
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	M.F.S.
100.0xCJ	M.F.S.
100.0xCJ	M.F.S.
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	BOECO
100.0xCJ	M.F.S.
100.0xCJ	BOECO
1.0UD	NACIONAL
1.0UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Ff.

	PRESENT	MARCA
• FRASCO GOTERO PLASTICO DE 100 mL	1.0 UD	KARTELL
• FRASCO GOTERO, TAPA ESMERILADA VIDRIO CLARO50 mL	1.0 UD	BOECO
• FRASCO GOTERO, TAPA ESMERILADA VIDRIO CLARO 100 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO GOTERO, TAPA ESMERILADA VIDRIO AMBAR 50 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO GOTERO, TAPA ESMERILADA VIDRIO AMBAR 100 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO LAVADOR PLASTICO GRADUADO DE 250 mL	1.0UD	VIT-LAB(ALE)
• FRASCO LAVADOR PLASTICO GRADUADO DE 500 ml	1.0UD	VIT-LAB(ALE)
• FRASCO LAVADOR PLASTICO GRADUADO DE 1000 mL	1.0UD	VIT-LAB(ALE)
• FRASCO PARA BURETA, VIDRIO CLARO DE 2000 mL	1.0UD	IMPORTADO
• FRASCO PARA BURETA, VIDRIO CLARO DE 2000 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• FRASCO PARA BURETA, VIDRIO AMBAR DE 2000 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• FRASCO PARA OXIGENO 300ml. (WINKLER) CON IDENTIFICACION ALTO RELIEVE EN LA BASE	1.0UD	WHEATON
• FRASCO PLASTICO DE 1000 ml CON DOSIFICADOR DE 50ml	1.0UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO POLIETILENO GRADUADO TAPA ROSCA DE 50 mL	1.0UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO POLIETILENO GRADUADO TAPA ROSCA DE 100 mL	1.0 UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Ff.

	PRESENT	MARCA
• FRASCO PLASTICO POLIETILENO GRADUADO TAPA ROSCA DE 250 mL	1.0 UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO POLIETILENO GRADUADO TAPA ROSCA DE 500 mL	1.0UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO POLIETILENO GRADUADO TAPA ROSCA DE 1000 mL	1.0UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO POLIETILENO GRADUADO TAPA ROSCA DE 2000 mL	1.0UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO PP GRADUADO AUTOCLAVABLE TAPA ROSCA DE 100 mL	1.0UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO PP GRADUADO AUTOCLAVABLE TAPA ROSCA DE 250 mL	1.0UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO PP GRADUADO AUTOCLAVABLE TAPA ROSCA DE 500 mL	1.0UD	KARTELL
• FRASCO PLASTICO PP GRADUADO AUTOCLAVABLE TAPA ROSCA DE 1000mL	1.0UD	KARTELL
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE50 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE100 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE250 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE500 ml	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE500 ml	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIOCLARO DE 1000 ml	1.0UD	SIMAX (ALE)
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 1000 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 1000 ml.	1.0UD	LABGILLS (ESP)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Ff.

	PRESENT	MARCA
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIOCLARO DE 2000 mL	1.0 UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 100 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 100 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 250 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 250 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 500 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 1000 mL	1.0UD	BOECO
• FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR DE 2000 mL	1.0UD	BOECO

Gg.

• GAFAS DE SEGURIDAD UNILENTE EN POLICARBONATO CLARO	1.0 UD	IMPORTADO
• GARRAFON PLASTICO POLIETILENO, AUTOCLAVE, CON LLAVE, 10 Lts	1.0UD	KARTELL
• GARRAFON PLASTICO POLIETILENO, AUTOCLAVE, CON LLAVE, 25 Lts	1.0UD	KARTELL
• GARRAFON PLASTICO POLIETILENO, AUTOCLAVE, SIN LLAVE, 5 Lts, BOCA ANCHA	1.0UD	KARTELL
• GARRAFON PLASTICO POLIETILENO, AUTOCLAVE, SIN LLAVE, 10 Lts, BOCA ANCHA	1.0 UD	KARTELL
• GARRAFON-ACCESORIO: LLAVE PLASTICA PARA GARRAFON 3/4'	1.0 UD	E&Q

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Gg.

	PRESENT	MARCA
• GOTERO PLASTICO	1.0 UD	NACIONAL
• GRADILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA 20 TUBOS DE 18 mm ø	1.0UD	GEMMY
• GRADILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA 24 TUBOS DE 18 mm ø.	1.0UD	GEMMY
• GRADILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA 40 TUBOS DE 18 mm ø.	1.0UD	GEMMY
• GRADILLA EN ACRILICO PARA 4 TUBOS FORMA ZANAHORIA DE 100 ml	1.0UD	E&Q
• GRADILLA EN ACRILICO PARA 6 TUBOS NESSLER	1.0UD	E&Q
• GRADILLA EN ACRILICO PARA 24 TUBOS NESSLER	1.0UD	E&Q
• GRADILLA METALICA PARA 4 TUBOS FORMA ZANAHORIA DE 100 ml	1.0UD	L-K INDUSTRIES
• GRADILLA PLASTICA PP PARA21 TUBOS DE 30 mm (CENTRIFUGA DE 50 ml Y NESSLER)	1.0UD	POBEL
• GRADILLA PLASTICA PP PARA 24 TUBOS DE 25 mm (CENTRIFUGA DE 15 ml Y NESSLER)	1.0UD	POBEL
• GRADILLA PLASTICA PP PARA40 TUBOS DE 20 mm	1.0UD	KARTELL
• GRADILLA PLASTICA PP PARA40 TUBOS DE 20 mm.	1.0UD	POBEL
• GRADILLA PLASTICA PP PARA60 TUBOS DE 16 mm	1.0UD	POBEL
• GRADILLA PLASTICA PP PARA 60 TUBOS DE 16 mm	1.0UD	KARTELL
• GRADILLA PLASTICA PP PARA90 TUBOS DE 13 mm	1.0UD	POBEL
• GRADILLA PLASTICA PP PARA 90 TUBOS DE 13 mm	1.0 UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Gg.

- GRADILLA PLASTICA PP PARA 100 TUBOS DE 1.5 mL BLANCA
- GUANTES DE LATEX BLANCO EXAMEN NO ESTERIL TALLA L
- GUANTES DE LATEX BLANCO EXAMEN NO ESTERIL TALLA L
- GUANTES DE LATEX BLANCO EXAMEN NO ESTERIL TALLA M
- GUANTES DE LATEX BLANCO EXAMEN NO ESTERIL TALLA S
- GUANTES DE NITRILO, CORTO 24.5 cm AZUL, TALLA L
- GUANTES DE NITRILO, CORTO 24.5 cm AZUL, TALLA M
- GUANTES DE NITRILO, CORTO 24.5 cm AZUL, TALLA S
- GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL, TALLA L
- GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL, TALLA M
- GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL, TALLA S

PRESENT	MARCA
1.0 UD	KARTELL
100.0xCJ	KRAMER
100.0xCJ	KRAMER
100.0xCJ	KRAMER
100.0xCJ	PRECISION
100.0xCJ	MICROFLEX
100.0xCJ	MICROFLEX
100.0xCJ	MICROFLEX
50.0xCJ	MICROFLEX
50.0xCJ	MICROFLEX
50.0xCJ	MICROFLEX

Hh.

- HIDROMETRO ASTM 2H 9-21 API 0.1
- HIDROMETRO ASTM 2H 9-21 API 0.1
- HIDROMETRO ASTM 3H 19-31 API 0.1
- HIDROMETRO ASTM 3H 19-31 API 0.1
- HIDROMETRO ASTM 4H 29-41 API 0.1

PRESENT	MARCA
1.0 UD	CHASE
1.0UD	L-K INDUSTRIES
1.0UD	CHASE
1.0UD	L-K INDUSTRIES
1.0UD	CHASE

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Hh.

- HIDROMETRO ASTM 8H 69-81 API 0.1
- HIDROMETRO ASTM 9H 79-91 API

PRESENT	MARCA
1.0 UD	CHASE
1.0UD	CHASE

Jj.

- JARRA PLASTICA (VASO) EN PP, CON MANIJA, FORMA BAJA, 500 mL, GRADUADA ALTO RELIEVE, AUTOCLAVABLE
- JARRA PLASTICA (VASO) EN PP, CON MANIJA, FORMA BAJA, 1000 mL, GRADUADA ALTO RELIEVE, AUTOCLAVABLE
- JARRA PLASTICA (VASO) EN PP, CON MANIJA, FORMA BAJA, 2000 mL, GRADUADA ALTO RELIEVE, AUTOCLAVABLE
- JARRA PLASTICA (VASO) EN PP, CON MANIJA, FORMA BAJA, 5000mL, GRADUADA ALTO RELIEVE, AUTOLAVABLE

1.0 UD	KARTELL KARTELL KARTELL
1.0UD	KARTELL
1.0UD	
1.0UD	

Kk.

- KOLOR KUT, VER PASTA DETECTORA DE ...

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



LI.

	PRESENT	MARCA
• LACTODENSIMETRO SIN TERMOMETRO 1.015 - 1.040 QUEVENNE	1.0 UD	BOECO
• LACTODENSIMETRO SIN TERMOMETRO 1.020 - 1.040 QUEVENNE	1.0UD	BOECO
• LAMINAS PORTAOBJETOS DE 3 X 1' (76 X 26 mm)	50.0xCJ	IMPORTADO
• LAMINILLAS CUBREOBJETOS DE 22 X 22 mm	100.0xCJ	IMPORTADO
• LAVADOR AUTOMATICO DE PIPETAS, EN POLIETILENO Y POLIPROPILENO, DE 170 mm DE DIAMETRO Y 734 mm DE ALT	1.0UD	KARTELL
• LAVADOR DE OJOS EN PLASTICO DE 500 ml	1.0UD	KARTELL
• LLAVE PARA DESECADOR, VER DESECADOR-ACCESORIO: LLAVE		

Mm.

• MACROPIPETEADOR PARA PIPETAS 0.1-100 mL	1.0 UD	BBOECO
• MACROPIPETEADOR REPUESTO: FILTRO DE MEMBRANA DE RECAMBIO, 3 µm, ESTERIL, HIDROFOBO, EN TEFLON	1.0UD	BOECO
• MECHA PARA MECHERO	12.0xCJ	NACIONAL
• MECHERO METALICO MICROBUNSEN CON REGULADOR TIPO FISCHER	1.0UD	NACIONAL
• MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA DE 0.20 MICRAS, 25mm, BLANCA, CUADRICULADA, CON PAD INDIVIDUAL ESTER	100.0xCJ	M.F.S.

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO




Mm.

	PRESENT	MARCA
• MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA DE 0.20 MICRAS, 47mm, BLANCA, CUADRICULADA PAD INDIVIDUAL ESTERIL	100.0 xCJ	M.F.S.
• MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA DE 0.45 MICRAS, 47 mm , SIN PAD, ESTERIL	100.0xCJ	M.F.S.
• MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA DE 0.45 MICRAS, 47mm , BLANCA, CUADRICULADA CON PAD INDIVIDUAL ESTER	100.0xCJ	M.F.S.
• MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA DE 0.8 MICRAS, 47 mm , SIN PAD, ESTERIL	1000.0 xCJ	M.F.S.
• MEMBRANA DE NYLON DE 0.22 MICRAS, 13mm, BLANCA	100.0xCJ	M.F.S.
• MEMBRANA DE NYLON DE 0.22 MICRAS, 47mm, BLANCA	100.0xCJ	M.F.S.
• MEMBRANA DE NYLON DE 0.45 MICRAS, 13mm, BLANCA	100.0xCJ	M.F.S.
• MICROESPATULA EN ACERO INOXIDABLE,DOBLE (ESPATULA -CUCHARA) DE 150 X 5 mm	1.0UD	BOECO
• MICROESPATULA EN ACERO INOXIDABLE,DOBLE (ESPATULA -ESPATULA) DE 150 X 3 mm	1.0UD	BOECO
• MICROESPATULA EN ACERO INOXIDABLE,DOBLE (ESPATULA -ESPATULA) DE 150 X 6 mm	1.0 UD	BOECO
• MICROHEMATOCRITO HEPARINIZADOS	100.0xPQ	IMPORTADO
• MICROHEMATOCRITO NO HEPARINIZADOS	100.0xPQ	IMPORTADO
• MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 0,5 - 10 uL (0,1)	1.0UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

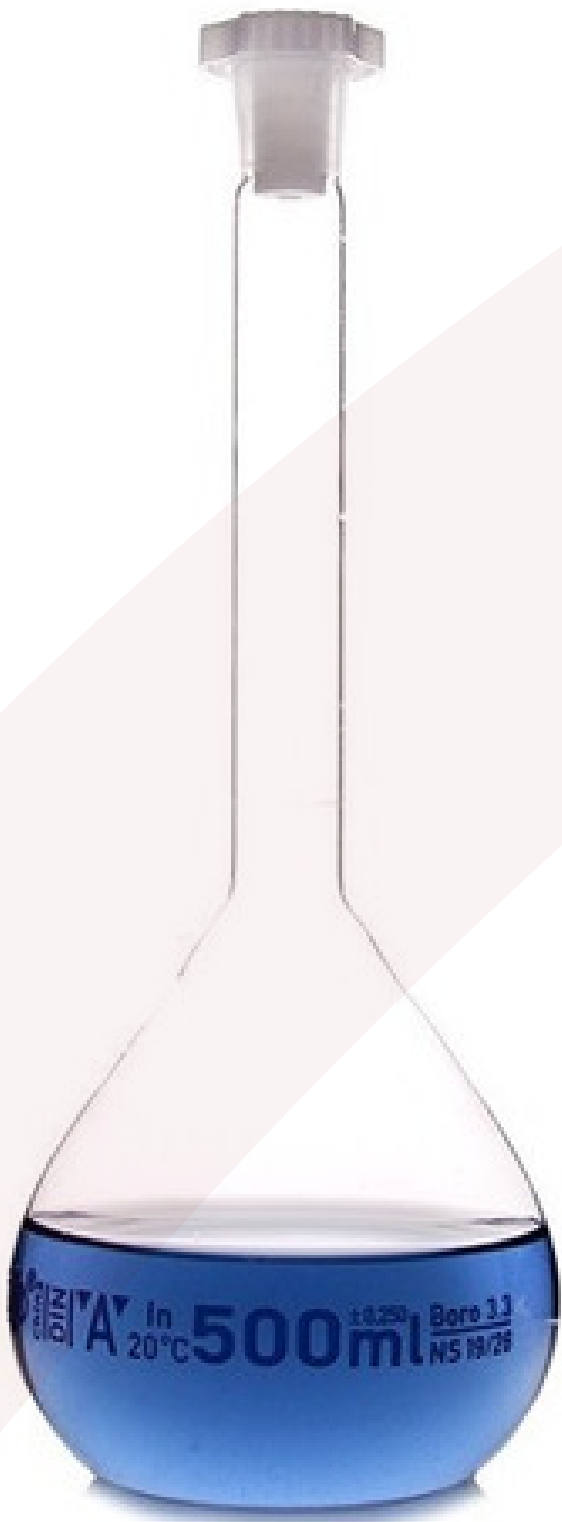

Mm.

	PRESENT	MARCA
• MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 2 - 20 uL (0,1)	1.0 UD	ACCUMAX
• MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 2 - 20 µL (0,1)	1.0UD	KARTELL
• MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20 - 100 uL (1)	1.0UD	KARTELL
• MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20 - 200 uL (1)	1.0UD	KARTELL
• MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 100 - 1000 uL	1.0UD	BOECO
• MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 100 - 1000 uL (10)	1.0UD	KARTELL
• MORTERO - ACCESORIO: PISTILO DIAMETRO 36 mm LONGITUD 150 mm	1.0UD	JIPO (ALE)
• MORTERO EN PORCELANA DE 63 mm , CON PISTILO 213100 (50mL)	1.0UD	JIPO (ALE)
• MORTERO EN PORCELANA DE 63 mm , CON PISTILO 56/0A (70mL)	1.0UD	HLW
• MORTERO EN PORCELANA DE 83 mm , CON PISTILO 213101 (110mL)	1.0UD	JIPO (ALE)
• MORTERO EN PORCELANA DE 90 mm , CON PISTILO 213300 (160 mL)	1.0UD	JIPO (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Mm.

- MORTERO EN PORCELANA DE 115 mm , CON PISTILO 56/4 (300 mL)
- MORTERO EN PORCELANA DE 144 mm , CON PISTILO 213400 (325 mL)

PRESENT MARCA

1.0 UD AHLW
1.0UD JIPO (ALE)

Nn.

- NUEZ DOBLE EN ALUMINIO

1.0 UD BOECO

Pp.

- PANEL DE ESCURRIDO EN POLIESTIRENO, 72 VASTAGOS
- PAPEL PARAFILM DE 38 mts. X 10 cms
- PAPEL PARAFILM DE 38 mts. X 10 cms.
- PASTA DETECTORA DE AGUA (3 oz. POR TUBO)
- PASTA DETECTORA DE COMBUSTIBLE (2.25 oz. POR FRASCO)
- PERA PIPETeadora UNIVERSAL DE CAUCHO, 3 VIAS
- PERA SOPLADORA PARA BURETA
- PERLAS DE VIDRIO PARA EBULLICION. 4mm ø
- PERLAS DE VIDRIO PARA EBULLICION. 4mm ø.
- PESAFILTROS FORMA BAJA 50X25mm (20mL)
- PESAFILTROS FORMA BAJA 50X35mm (35mL)
- PESASUSTANCIAS, VER PESAFILTROS...
- PICNOMETRO SIN TERMOMETRO DE 5 mL


1.0 UD KARTELL
1.0UD 3M
1.0UD BRAND
1.0UD KOLOR KUT
1.0UD KOLOR KUT

1.0UD KARTELL
1.0UD BOECO
1.0kg SUPERIOR
1.0kg POBEL
1.0UD IMPORTADO
1.0UD IMPORTADO

1.0UD LMS (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

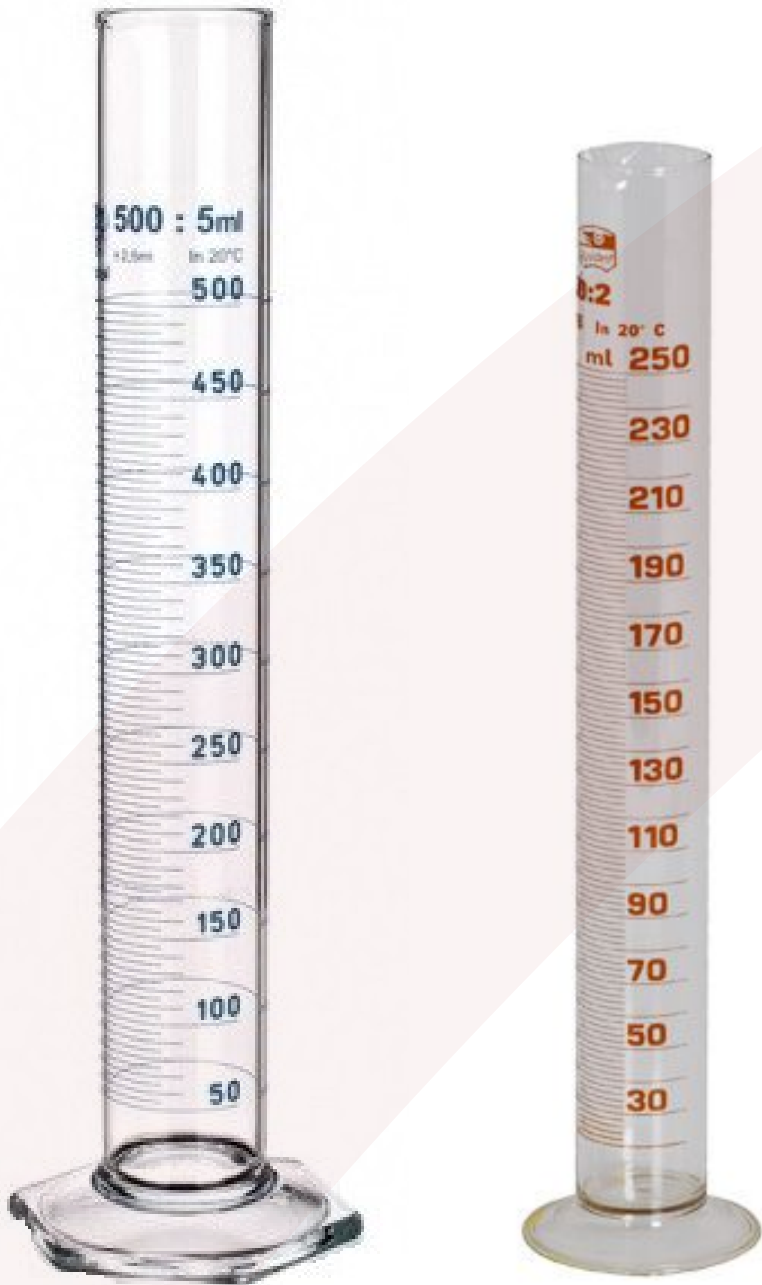

Pp.

	PRESENT	MARCA
• PICNOMETRO SIN TERMOMETRO DE 10 mL	1.0 UD	LMS (ALE)
• PICNOMETROSIN TERMOMETRO DE 25 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETROSIN TERMOMETRO DE 50 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETROSIN TERMOMETRO DE 5 mL (CALIBRADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETROSIN TERMOMETRO DE 5 mL. (CALIBRADO CON CERTIFICADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETROSIN TERMOMETRO DE 10 mL (CALIBRADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETROSIN TERMOMETRO DE 10 mL. (CALIBRADO CON CERTIFICADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETROSIN TERMOMETRO DE 25 mL (CALIBRADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETROSIN TERMOMETRO DE 25 mL. (CALIBRADO CON CERTIFICADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETRO CON TERMOMETRO DE 10 mL (CALIBRADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETRO CON TERMOMETRO DE 10 mL. (CALIBRADO CON CERTIFICADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETRO CON TERMOMETRO DE 25 mL (CALIBRADO)	1.0 UD	LMS (ALE)
• PICNOMETRO CON TERMOMETRO DE 25 mL. (CALIBRADO CON CERTIFICADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETRO CON TERMOMETRO DE 50 mL (CALIBRADO)	1.0UD	LMS (ALE)
• PICNOMETRO CON TERMOMETRO DE 50 mL. (CALIBRADO CON CERTIFICADO)	1.0UD	LMS (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Pp.

	PRESENT	MARCA
• PINZA SENCILLA PARA BURETA (PLASTICA)	1.0 UD	KARTELL
• PINZA DOBLE PARA BURETA (PLASTICA)	1.0UD	KARTELL
• PINZA DOBLE PARA BURETA, EN ALUMINIO	1.0UD	BOECO
• PINZA MOHR, VER SEGURO PLASTICO PARA CORTAR FLUJO...		
• PINZA PARA CRISOLES EN ACERO, DE 300 mm.	1.0UD	BOECO
• PINZA PARA ERLLENMEYER EN ACERO	1.0UD	BOECO
• PINZA PARA MEMBRANA, EN ACERO, DE 105 mm	1.0UD	BOECO
• PINZA PARA MEMBRANA, PLASTICA, AUTOCLAVABLE, 115mm	1.0UD	KARTELL
• PINZA PARA VASO EN ACERO, DE 250 mm	1.0UD	BOECO
• PIPETA GRADUADA CLASE B DE0.1 mL (0.001 ml)	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE BDE 0.5 ml (0.010 ml)	1.0UD	SCHOTT
• PIPETA GRADUADA CLASE BDE 0.5 ml (0.010 ml)	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE BDE 1 ml (0.010 ml)	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE BDE 2 ml (0.020 ml)	1.0UD	SCHOTT
• PIPETA GRADUADA CLASEB DE 2 ml(0.020 ml)	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE BDE 2 ml (0.010 ml)	1.0UD	H.B.G.
• PIPETA GRADUADA CLASE BDE 5 ml (0.100)	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE B DE 10 ml (0.10 ml)	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE B DE 20 ml (0.10 ml)	1.0UD	SCHOTT
• PIPETA GRADUADA CLASE B DE 20 ml (0.10 ml)	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE B DE 25 ml (0.10 ml)	1.0UD	H.B.G.
• PIPETA GRADUADA CLASEB DE 25 ml (0.10 ml)	1.0UD	SCHOTT

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Pp.

	PRESENT	MARCA
• PIPETA GRADUADA CLASEB DE 25 ml (0.10 ml)	1.0 UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE A DE 0.1 ml (0.001) CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE A DE 1 ml (0.010) CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE A DE 2 ml (0.020) CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE A DE 5 ml (0.100) CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE A DE 10 ml (0.100) CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE A DE 20 ml (0.100) CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA GRADUADA CLASE A DE 25 ml (0.100) CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA PASTEUR PLASTICA NO ESTERIL LONG. 160 mm CAP. 1 ml	500.0xPQ	KARTELL
• PIPETA PASTEUR PLASTICA NO ESTERIL LONG. 160 mm CAP. 3 ml	500.0xPQ	KARTELL
• PIPETA VOLUMETRICA CLASE B DE2 mL	1.0UD	BRAND
• PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 0.5 ml, CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)
• PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE1 ml, CERTIFICADA POR LOTE	1.0UD	LMS (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

Pp.




- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 2 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 3 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 4 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 5 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 6 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 9 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 10 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 11 ml, PARA LECHE
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 15 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 20 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 25 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 40 ml
- PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 50 ml
- PIPETEADOR PLASTICO 0-2 mL AZUL
- PIPETEADOR PLASTICO 0- 2 mL AZUL
- PIPETEADOR PLASTICO 0-10 mL VERDE
- PIPETEADOR PLASTICO 0-10 ml VERDE
- PIPETEADOR PLASTICO 0-25 ml ROJO
- PISTILO, VER MORTERO - ACCESORIO
- PLACA PROTECTORA CERAN DE 175 X 175 mm
- PLACA Y TAPA PARA DESECADOR, VER DESECADOR - ACCESORIO...
- PLACAS PARA MICROTITULACION - ACCESORIO: TAPAS PARA PLACAS PARA MICROTITULACION DE 96 POZOS

PRESENT	MARCA
1.0 UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0 UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	LMS (ALE)
1.0UD	FRANCE
1.0UD	BOECO
1.0UD	FRANCE
1.0UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	SCHOTT
50.0xCJ	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

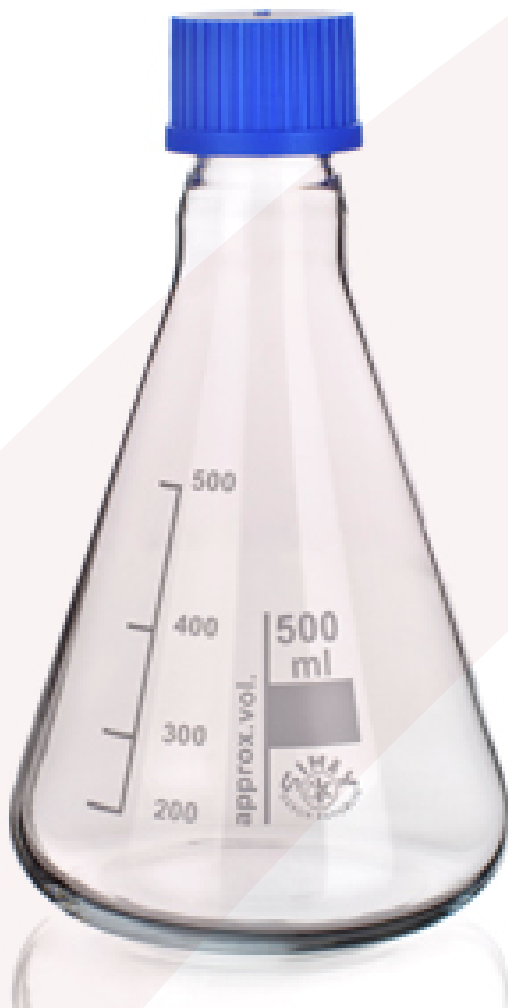

Pp.

	PRESENT	MARCA
• PLACAS PARA MICROTITULACION DE 96 POZOS, FONDO RECTO, SIN TAPA (VER REF.2623)	50.0 xCJ	LKARTELL
• PLACAS PARA MICROTITULACION DE 96 POZOS, FONDO REDONDO, SIN TAPA (VER REF.2623)	50.0xCJ	KARTELL
• PLOMADA DE BRONCE (DE VACIO) CUADRADA GRADUADA	1.0UD	LUFKIN
• PLOMADA DE BRONCE DE 20 ONZAS GRADUADA	1.0UD	LUFKIN
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B BASEPLASTICA DE 10 mL (0.2) mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B BASEPLASTICA DE 25 mL (0.5) mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B BASEPLASTICA DE 50 mL (1.0) mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B BASEPLASTICA DE 100 mL (1.0) mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B BASEPLASTICA DE 250 mL (2.0) mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B BASEPLASTICA DE 500 mL (5.0) mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B BASEPLASTICA DE 1000 mL (10.0) mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B BASE HEXAG, VIDRIO 10 mL (0.2 mL)	1.0UD	LMS (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Pp.

	PRESENT	MARCA
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A BASE HEXAGONAL DE VIDRIO 250 mL (2.0 mL)	1.0 UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A BASE HEXAGONAL DE VIDRIO 500 mL (5.0 mL)	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A BASE HEXAGONAL DE VIDRIO 1000 mL (10.0 mL)	1.0UD	DURAN
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A BASE HEXAGONAL DE VIDRIO 1000 mL (10.0 mL)	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A BASE HEXAGONAL DE VIDRIO 2000 mL (20.0 mL)	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA MEZCLADORA TAPON VIDRIO, CLASE B, DE 50. mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA MEZCLADORA TAPON VIDRIO, CLASE B, DE 100. mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA MEZCLADORA TAPON VIDRIO, CLASE B, DE 250 mL	1.0UD	LMS (ALE)
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE10 ml GRADUACION ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 25 ml GRADUACION ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 50 ml GRADUACION ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 100 ml GRADUACION ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO




Pp.

	PRESENT	MARCA
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 250 ml GRADUACION EN ALTO RELIEVE	1.0 UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 500 ml GRADUACION EN ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 1000 ml GRADUACION EN ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 2000 ml GRADUACION EN ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS, DE 2-200 uL	1000.0 xPQ	KARTELL
• PUNTAS AZULES PARA PIPETAS, DE 100-1000 uL	1000.0 xPQ	KARTELL
• PUNTAS TRANSPARENTES PARA PIPETAS, DE 0,5-10 uL	1000.0 xPQ	KARTELL
• PUNTAS TRANSPARENTES PARA PIPETAS, DE 100-1000 uL, CON FILTRO ESTERILIZADAS EN RACK, LIBRE DE DNA Y RNA	96.0xPQ	KARTELL
• RASTRILLO EN VIDRIO 7 x 140 mm (ASA DE DRIGALSKY)	1.0UD	NACIONAL
• SEGURO PLASTICO PARA CORTAR FLUJO EN MANGUERA DE LATEX Y/O SILICONA (PINZA MOHR PLASTICA)	1.0UD	FISHER
• SEGURO PLASTICO NS 14/23 AMARILLO PARA UNIONES EN VIDRIO	1.0UD	KARTELL
• SEGURO PLASTICO NS 19/26 AZUL PARA UNIONES EN VIDRIO	1.0UD	KARTELL
• SEGURO PLASTICO NS 24/29 VERDE PARA UNIONES EN VIDRIO	1.0UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

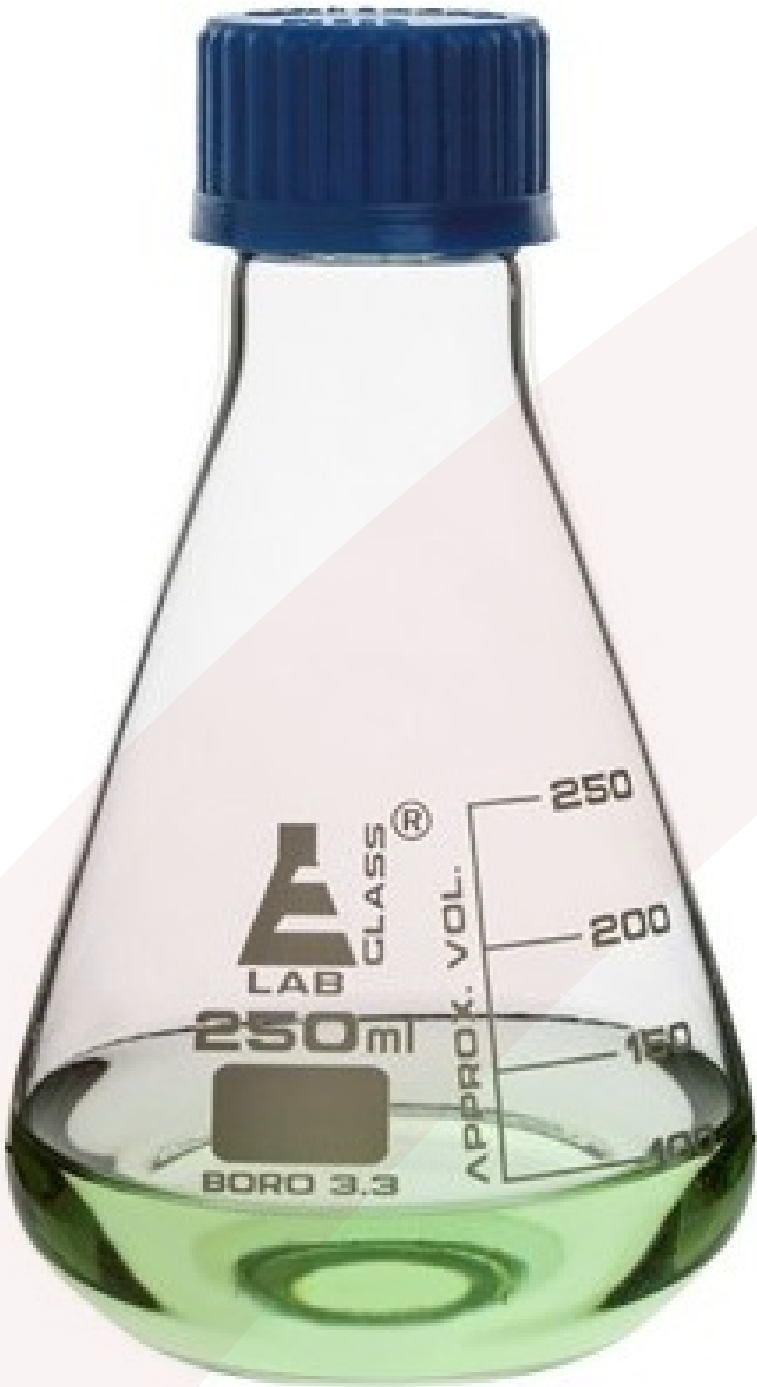

Pp.

	PRESENT	MARCA
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 250 ml GRADUACION EN ALTO RELIEVE	1.0 UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 500 ml GRADUACION EN ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 1000 ml GRADUACION EN ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PROBETA PLASTICA EN PP, DE 2000 ml GRADUACION EN ALTO RELIEVE	1.0UD	KARTELL
• PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS, DE 2-200 uL	1000.0 xPQ	KARTELL
• PUNTAS AZULES PARA PIPETAS, DE 100-1000 uL	1000.0 xPQ	KARTELL
• PUNTAS TRANSPARENTES PARA PIPETAS, DE 0,5-10 uL	1000.0 xPQ	KARTELL
• PUNTAS TRANSPARENTES PARA PIPETAS, DE 100-1000 uL, CON FILTRO ESTERILIZADAS EN RACK, LIBRE DE DNA Y RNA	96.0xPQ	KARTELL

Rr.

• RASTRILLO EN VIDRIO 7 x 140 mm (ASA DE DRIGALSKY)	1.0 UD	NACIONAL
---	--------	----------

Sr.

• SEGURO PLASTICO PARA CORTAR FLUJO EN MANGUERA DE LATEX Y/O SILICONA (PINZA MOHR PLASTICA)	1.0 UD	FISHER
• SEGURO PLASTICO NS 14/23 AMARILLO PARA UNIONES EN VIDRIO	1.0 UD	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO




Ss.

	PRESENT	MARCA
• SEGURO PLASTICO NS 19/26 AZUL PARA UNIONES EN VIDRIO	1.0 UD	KARTELL
• SEGURO PLASTICO NS 24/29 VERDE PARA UNIONES EN VIDRIO	1.0UD	KARTELL
• SEGURO PLASTICO NS 24/29 VERDE PARA UNIONES EN VIDRIO.	1.0UD	POBEL
• SEGURO PLASTICO NS 29/32 ROJO PARA UNIONES EN VIDRIO	1.0UD	KARTELL
• SOPORTE LINEAL EN ACRILICO PARA 6 MICROPIPETAS	1.0UD	E&Q
• SOPORTE LINEAL EN ACRILICO PARA 12 PIPETAS	1.0UD	E&Q
• SOPORTE PLASTICO PARA 12 CUBETAS DE 10 mm DE BASE	1.0UD	KARTELL
• SOPORTE PLASTICO PARA 20 TUBOS EPPENDORF	1.0UD	KARTELL
• SOPORTE PLASTICO PARA EMBUDO DE SEPARACION	1.0UD	KARTELL
• SOPORTE PLASTICO PARA 1 CONO IMHOFF EN ACRILICO	1.0UD	E&Q
• SOPORTE PLASTICO PARA 2 CONOS IMHOFF	1.0UD	KARTELL
• SOPORTE PLASTICO PARA 2 CONOS IMHOFF EN ACRILICO	1.0UD	E&Q
• SOPORTE PLASTICO PARA. 94 PIPETAS	1.0UD	KARTELL
• SOPORTE UNIVERSAL EN HIERRO 13 x 21 cm VARILLA DE 70 cm	1.0UD	E&Q
• SOPORTE UNIVERSAL EN HIERRO BASE TRIANGULAR DE 13 cm VARILLA DE 70 cm	1.0UD	NACIONAL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

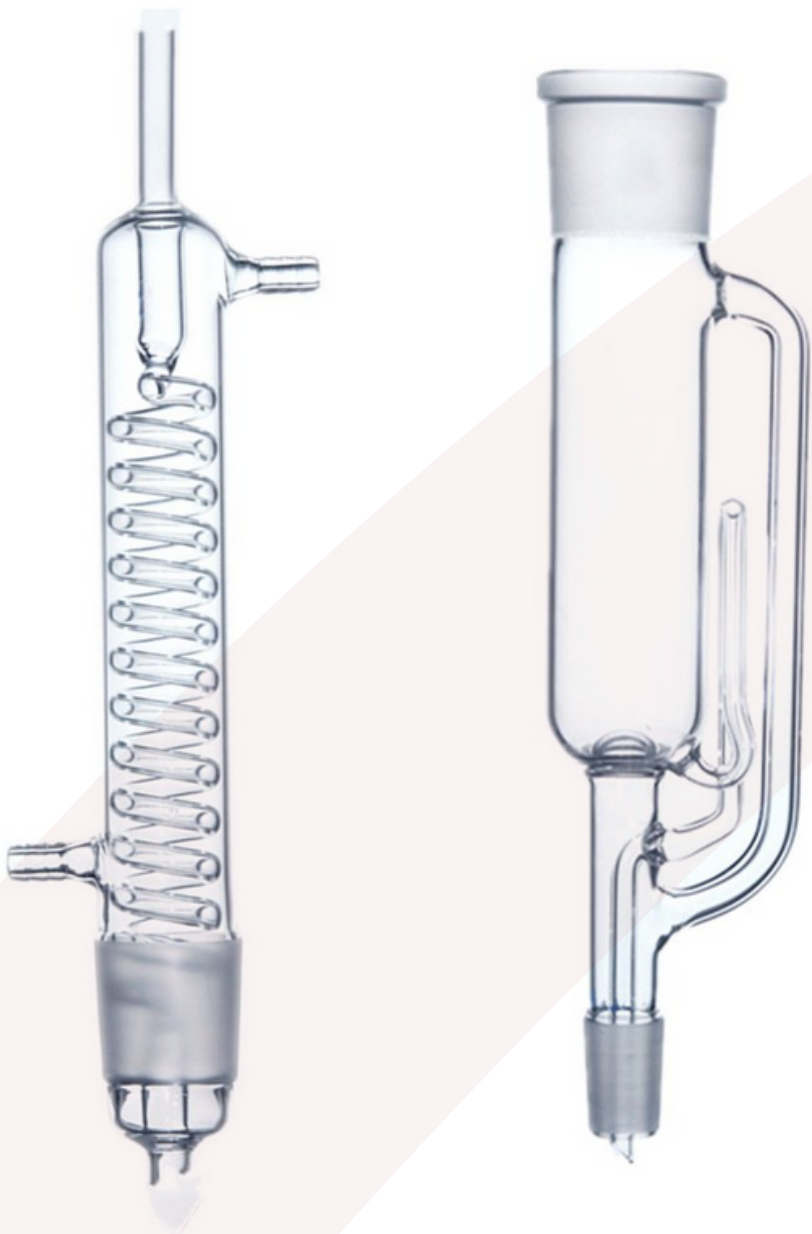

Tt.

	PRESENT	MARCA
• TAMIZ ACERO INOXIDABLE 8' DIAM No. 40 (425 µm) CERTIF.ISO 3310.1	1.0 UD	CISA (ESP)
• TAMIZ ACERO INOXIDABLE 8' DIAM No. 60 (250 µm) CERTIF.ISO 3310.1	1.0UD	CISA(ESP)
• TAMIZ ACERO INOXIDABLE 8' DIAM No. 200 (75 µm) CERTIF.ISO 3310.1	1.0UD	CISA(ESP)
• TAMIZ ACERO INOXIDABLE 8' DIAM No. 270 (53 µm) CERTIF.ISO 3310.1	1.0UD	CISA(ESP)
• TAMIZ ACERO INOXIDABLE 8' DIAM No. 325 (45 µm) CERTIF.ISO 3310.1	1.0UD	CISA(ESP)
• TAMIZ EN ACERO INOXIDABLE DE 12" DE DIAMETRO MALLA No. 70	1.0UD	NACIONAL
• TAMIZ EN ACERO INOXIDABLE DE 8' DE DIAMETRO MALLA No. 200	1.0UD	NACIONAL
• TAPA PARA CRISOL, VER CRISOL - ACCESORIO: TAPA ...		
• TAPA Y PLACA PARA DESECADOR, VER DESECADOR - ACCESORIO...		
• TAPON DE CAUCHO NATURAL TIPO SEPTA 14/20	10.0xPQ	ALDRICH
• TAPON DE CAUCHO NATURAL TIPO SEPTA 24/40	10.0xPQ	ALDRICH
• TAPON DE CORCHO SURTIDO	50.0xPQ	NACIONAL
• TAPON DE GOMA PARA BUTIROMETRO CONICO	1.0UD	BOECO
• TERMOHIDROMETRO (0-150)°F 9-21 API	1.0UD	CHASE
• TERMOHIDROMETRO (0-150)°F9-21 API	1.0UD	L-K INDUSTRIES
• TERMOHIDROMETRO (0-150)°F 19-31 API	1.0UD	CHASE

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Tt.

	PRESENT	MARCA
• TERMOHIDROMETRO (0-150)°F 29-41 API	1.0 UD	CHASE
• TERMOHIDROMETRO (0-150)°F 29-41 API	1.0UD	L-K INDUSTRIES
• TERMOHIDROMETRO (0-150)°F 39-51 API	1.0UD	CHASE
• TERMOHIDROMETRO (0-150)°F 39-51 API	1.0 UD	L-K INDUSTRIES
• TERMOHIDROMETRO (60-220)°F 29-41 API	1.0UD	L-K INDUSTRIES
• TERMOHIGROMETRO DIGITAL, 0-50°C, 25-95% H.R.	1.0UD	BOECO
• TERMOLACTODENSIMETRO 1020 -1040 - 15 GRADOS, GERBER	1.0UD	BOECO
• TERMOLACTODENSIMETRO 1020 -1040 - 20 GRADOS, GERBER	1.0UD	BOECO
• TERMOMETRO DE PUNZON DE -10 A 150°C (0.2°C), CARATULA DE 25 mm	1.0UD	BOECO
• TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS, -30 A 50°C SIN MERCURIO	1.0UD	BOECO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 5 + 215°F, 42 cm, ASTM 12F	1.0UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 +50°C, (1°C), 30 cm	1.0UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 + 100°C, (1°C), 30 cm, FONDO BLANCO, INMERSION TOTAL	1.0UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 + 110°C, (1°C), 30 cm	1.0UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 + 150°C, (1°C), 30 cm	1.0UD	IMPORTADO

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Tt.

	PRESENT	MARCA
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 + 200°C, (2°C), 30 cm	1.0 UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 + 250°C, (2°C), 30 cm	1.0UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 + 360°C, (2°C), 30 cm	1.0UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 + 400°C, (2°C), 34 cm	1.0UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO DE MERCURIO - 10 + 450°C, (1°C), 30 cm, FONDO BLANCO, INMERSION TOTAL	1.0UD	IMPORTADO
• TERMOMETRO DE VIDRIO EN ALCOHOL - 10 + 50°C, (1°C)	1.0UD	LAB SCIENT
• TERMOMETRO DE VIDRIO EN ALCOHOL - 10 + 110°C, (1°C)	1.0UD	LAB SCIENT
• TERMOMETRO DE VIDRIO EN ALCOHOL - 10 + 150°C, (1°C)	1.0UD	LAB SCIENT
• TERMOMETROS DIGITALES: VER LISTA EQUIPOS IMPORTADOS		
• TIMER DIGITAL PARA LABORATORIO DE 99 MINUTOS, 1 TIEMPO	1.0UD	BOECO
• TIMER DIGITAL PARA LABORATORIO DE 99 MINUTOS, 2 TIEMPOS	1.0UD	BOECO
• TOMA MUESTRAS LAZO DE 7 METROS	1.0UD	L-K INDUSTRIES
• TUBO DE ENSAYO LISO, DE VIDRIO 9 X 100 mm	1.0UD	SCHOTT
• TUBO DE ENSAYO LISO, DE VIDRIO 13 X 100 mm (9 mL)	1.0UD	SUPERIOR

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Tt.

	PRESENT	MARCA
• TUBO DE ENSAYO LISO, DE VIDRIO 16 X 100 mm (15ml)	1.0 UD	FISHER
• TUBO DE ENSAYO LISO, DE VIDRIO 16 X 100 mm (15ml)	1.0UD	SUPERIOR
• TUBO DE ENSAYO LISO, DE VIDRIO 16 X 150 mm (20 mL)	1.0UD	SUPERIOR
• TUBO DE ENSAYO LISO, PLASTICO 12X75 mm (5ml)	1000.0 xPQ	KARTELL
• TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 0.5 mL CON TAPA	1000.0 xPQ	KARTELL
• TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 1.5mL CONTAPA	1000.0 xPQ	KARTELL
• TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 2.0 mL CON TAPA	1000.0 xPQ	BOECO
• TUBO DELGADO DE 12.5 ml MARCADO CON PORCENTAJE	1.0UD	L-K INDUSTRIES
• TUBO EN VIDRIO LONGITUD 1500 mm		
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 7.0 mm ESPESOR 1.0 mm (7.5 K/CJ)	121.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT.7.0 mm ESPESOR 2.2 mm (14.0 K/CJ)	121.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 8.0 mm ESPESOR 1.0 mm (7.4 K/CJ)	100.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 10.0 mm ESPESOR 1.0 mm (6.1 K/CJ)	64.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 12.0 mm ESPESOR 1.0 mm (11.5 K/CJ)	100.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 13.0 mm ESPESOR 1.0 mm (10.2 K/CJ)	81.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 18.0 mm ESPESOR 1.2 mm (7.6 K/CJ)	36.0 xCJ	SIMAX (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Tt.

	PRESENT	MARCA
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 20.0 mm ESPESOR 1.2 mm (11.6 K/CJ)	49.0 xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 22.0 mm ESPESOR 1.2 mm (9.4 K/CJ)	36.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 22.0 mm ESPESOR 1.8 mm (13.8 K/CJ)	36.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 24.0 mm ESPESOR 1.2 mm (10.4 K/CJ)	36.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 24.0 mm ESPESOR 1.8 mm (15.1 K/CJ)	36.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 26.0 mm ESPESOR 1.4 mm (13 K/CJ)	36.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 26.0 mm ESPESOR 2.0 mm (18.1 K/CJ)	36.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 28.0 mm ESPESOR 1.4 mm (9.8 K/CJ)	25.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 28.0 mm ESPESOR 2.0 mm (13.7 K/CJ)	25.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 30.0 mm ESPESOR 1.4 mm (15.2 K/CJ)	36.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 30.0 mm ESPESOR 2.0 mm (21.2 K/CJ)	36.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 32.0 mm ESPESOR 1.4 mm (11.3 K/CJ)	25.0xCJ	SIMAX (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO




Tt.

	PRESENT	MARCA
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 32.0 mm ESPESOR 2.0 mm (15.8 K/CJ)	25.0 xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 34.0 mm ESPESOR 1.4 mm (7.7 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 34.0 mm ESPESOR 2.0 mm (10.8 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 36.0 mm ESPESOR 1.4 mm (8.1 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 38.0 mm ESPESOR 1.4 mm (8.6 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 40.0 mm ESPESOR 1.6 mm (10.3 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 42.0 mm ESPESOR 1.6 mm (10.9 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 42.0 mm ESPESOR 2.3 mm (15.4 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 44.0 mm ESPESOR 1.6 mm (11.4 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 46.0 mm ESPESOR 1.6 mm (12 K/CJ)	16.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 48.0 mm ESPESOR 1.6 mm (7 K/CJ)	9.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 48.0 mm ESPESOR 2.3 mm (9.9 K/CJ)	9.0xCJ	SIMAX (ALE)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

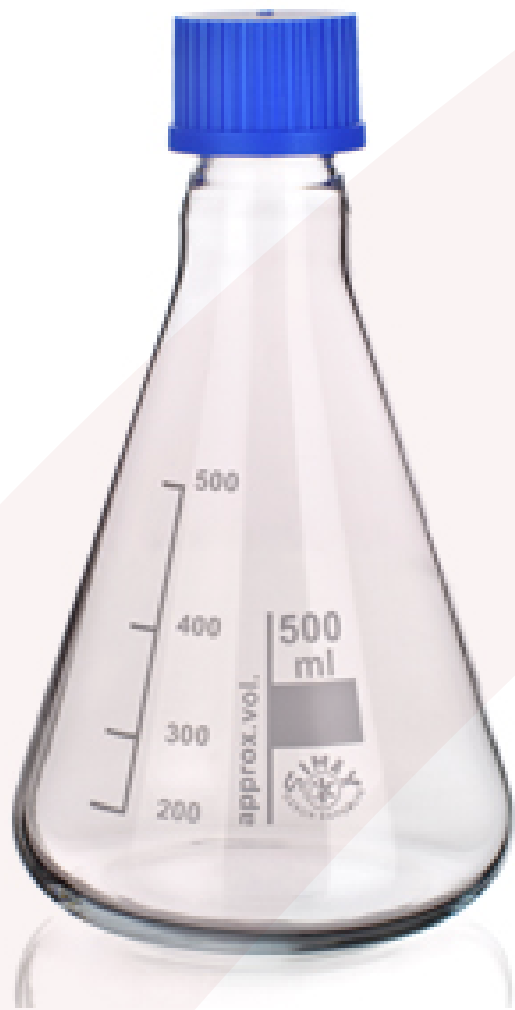

Tt.

	PRESENT	MARCA
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 50.0 mm ESPESOR 1.8 mm (10.9 K/CJ)	12.0 xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 54.0 mm ESPESOR 1.8 mm (8.9 K/CJ)	9.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 54.0 mm ESPESOR 2.5 mm (12.2 K/CJ)	9.0xCJ	KAVALIER
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 56.0 mm ESPESOR 1.8 mm (12.3 K/CJ)	12.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 58.0 mm ESPESOR 1.8 mm (12.8 K/CJ)	12.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO EN VIDRIO DIAM.EXT. 60.0 mm ESPESOR 2.2 mm (16.0 K/CJ)	12.0xCJ	SIMAX (ALE)
• TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO SIN GRADUAR DE 10 mL	1.0UD	SUPERIOR
• TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO SIN GRADUAR DE 15 mL	1.0UD	SUPERIOR
• TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO GRADUADO DE 15 mL, CONICO	1.0UD	SUPERIOR
• TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO GRADUADO TIPO ZANAHORIA DE 0-200 %	6.0xCJ	L-K INDUSTRIES
• TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO GRADUADO TIPO ZANAHORIA DE 0-200 %	1.0UD	L-K INDUSTRIES
• TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO GRADUADO TIPO ZANAHORIA DE 100 ml	6.0xCJ	L-K INDUSTRIES

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Tt.

- TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO GRADUADO TIPO ZANAHORIA DE 100 ml
- TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO GRADUADO TIPO ZANAHORIA DE 100 ml (DE 2 EN 2 ml A PARTIR DE 10 ml)
- TUBO PARA CENTRIFUGA, DE VIDRIO GRADUADO TIPO ZANAHORIA DE 100 ml (DE 2 EN 2 ml A PARTIR DE 10 ml)
- TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP GRADUADO, CONICO, 15 mL SIN TAPA , AUTOCLAVABLE
- TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP GRADUADO, TIPO FALCON, CONICO, 15 mL TAPA AZUL, AUTOCLAVABLE
- TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP GRADUADO, TIPO FALCON, CONICO, 15 mL, TAPA ROJA, AUTOCLAVABLE ESTERIL
- TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP GRADUADO, TIPO FALCON, CONICO, 50 mL TAPA AZUL, AUTOCLAVABLE
- TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP GRADUADO, TIPO FALCON, CONICO, 50 mL TAPA AZUL, CON BASE DE APOYO
- TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP GRADUADO, TIPO FALCON, CONICO, 50 mL, TAPA ROJA AUTOCLAVABLE ESTERIL

PRESENT	MARCA
1.0 UD	L-K INDUSTRIES
6.0xCJ	L-K INDUSTRIES
1.0 UD	L-K INDUSTRIES
1.0UD	KARTELL
150.0xPQ	KARTELL
150.0xPQ	KARTELL
100.0xPQ	KARTELL
100.0xPQ	KARTELL
100.0xPQ	KARTELL

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Tt.

- TUBO TAPA ROSCA, DE VIDRIO DE 13 X 100 mm (9 mL)
- TUBO TAPA ROSCA, DE VIDRIO DE 16 X 100 mm
- TUBO TAPA ROSCA, DE VIDRIO DE 16 X 125 mm
- TUBO TAPA ROSCA, DE VIDRIO DE 16 X 150 mm (20 mL)

PRESENT	MARCA
1.0 UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	CITOGLAS
1.0UD	BOECO

Vv.

- VARILLA AGITADORA EN VIDRIO 7 x 250 mm
- VARILLA AGITADORA EN VIDRIO 7 x 300 mm
- VARILLA AGITADORA EN VIDRIO 8 x 250 mm
- VARILLA AGITADORA EN VIDRIO 8 x 300 mm
- VARILLA AGITADORA PLASTICA 24,5 cm, PUNTAS PLANAS
- VARILLA EN VIDRIO DE 7 mm DE DIAMETRO (15.6 K/CJ)
- VARILLA EN VIDRIO DE 7 mm DE DIAMETRO, LONGITUD 1500 mm
- VARILLA EN VIDRIO DE 8 mm DE DIAMETRO (16.8 K/CJ)
- VARILLA EN VIDRIO DE 8 mm DE DIAMETRO, LONGITUD 1500 mm
- VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 25 mL
- VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 25 mL
- VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 50 mL
- VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 50 mL
- VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 100 mL
- VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 100 mL


PRESENT	MARCA
1.0 UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	BOECO
1.0UD	KARTELL
121.0xCJ	SIMAX (ALE)
1.0UD	SIMAX (ALE)
100.0xCJ	SIMAX (ALE)
1.0UD	SIMAX (ALE)
1.0UD	BOECO
1.0UD	LABGILLS (ESP)
1.0UD	BOECO
1.0UD	LABGILLS (ESP)
1.0UD	BOECO
1.0UD	LABGILLS (ESP)

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

Vv.

	PRESENT	MARCA
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 150 mL	1.0 UD	BBOECO
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 150 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 250 mL	1.0UD	BOECO
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 250 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 400 mL	1.0UD	BOECO
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 400 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 600 ml	1.0UD	BOECO
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 600 ml	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 800mL	1.0 UD	IMPORTADO
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 800 mL	1.0UD	BOECO
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 800 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 1000 mL	1.0UD	BOECO
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 1000 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 2000 mL	1.0UD	BOECO
• VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 2000 mL	1.0UD	LABGILLS (ESP)
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO(PMP), DE 100 ml, TRANSPARENTE	1.0UD	NALGENE
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PMP), DE 250 ml, TRANSPARENTE	1.0UD	NALGENE
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO(PP) DE 100 mL , GRADUACION AZUL PARED GRUESA	1.0UD	KARTELL
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 50 mL , GRADUACION AZUL PARED	1.0UD	KARTELL

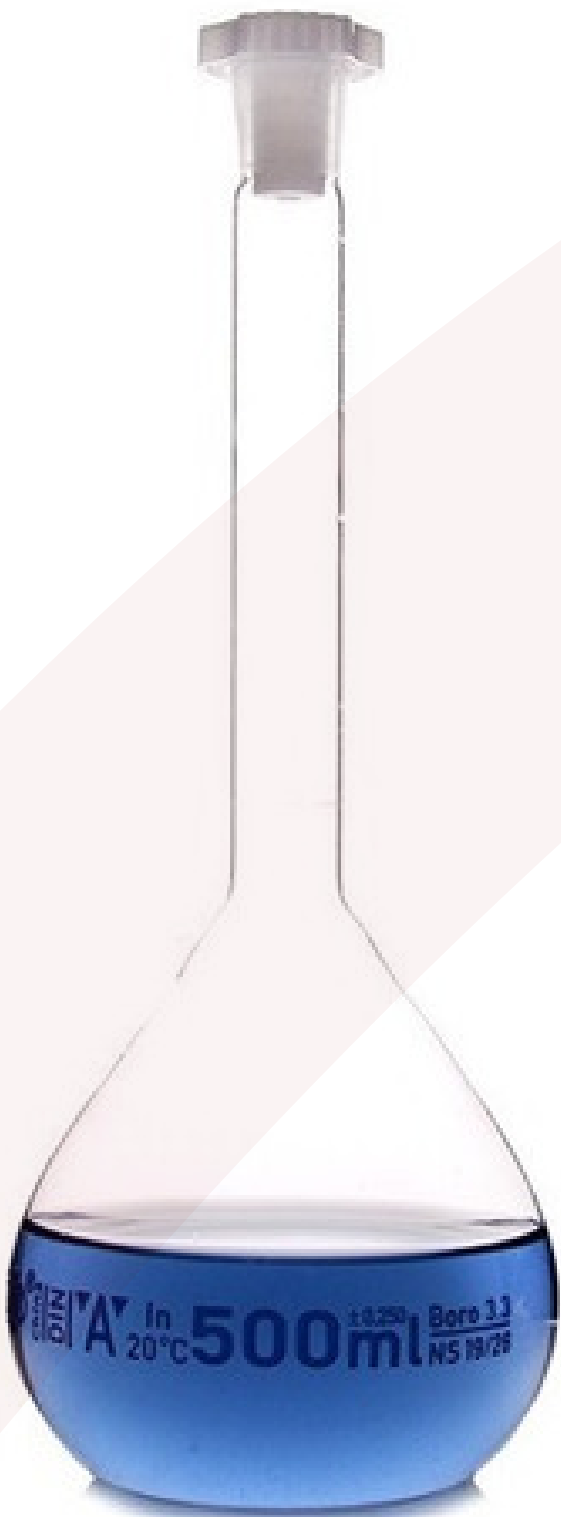

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO



Vv.

	PRESENT	MARCA
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO(PP) DE 50 mL,ALTO RELIEVE, PARED GRUESA	1.0 UD	KARTELL
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 100 ml	1.0UD	NALGENE
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 100 mL, ALTO RELIEVE, PARED GRUESA	1.0UD	KARTELL
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 250 ml	1.0UD	NALGENE
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 250 ml, ALTORELIEVE	1.0UD	FISHER
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 250 mL, GRADUACION AZUL PARED GRUESA	1.0UD	KARTELL
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 250 mL, ALTO RELIEVE, PARED GRUESA	1.0UD	KARTELL
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO(PP) DE 400 ml	1.0UD	NALGENE
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 400 ml ALTO RELIEVE	1.0UD	FISHER
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 500 mL, ALTO RELIEVE, PARED GRUESA	1.0UD	KARTELL
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 600 ml, ALTO RELIEVE	1.0UD	FISHER
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO(PP) DE 1000 mL, ALTO RELIEVE, PARED GRUESA	1.0UD	KARTELL
• VASO DE PRECIPITADO PLASTICO (PP)DE 2000 mL, ALTO RELIEVE, PARED GRUESA	1.0UD	KARTELL
• VIDRIO DE RELOJ DE 60 mm	1.0UD	PETRIQ

INDICE

VIDRIERIA DE LABORATORIO

Vv.

- VIDRIO DE RELOJ DE 70 mm
- VIDRIO DE RELOJ DE 80 mm
- VIDRIO DE RELOJ DE 100 mm
- VIDRIO DE RELOJ DE 150 mm

PRESENT	MARCA
1.0 UD	PETRIQ
1.0UD	PETRIQ
1.0UD	PETRIQ
1.0UD	PETRIQ



INFORMACIÓN DE CONTACTO



BIOSAF IMPORT
INNOVACIÓN & TECNOLOGÍA

Número de teléfono

310 7964506 - 320 4820558

Correo electrónico

asesor@biosafimport.com

Sede central

Cra 7 oeste N° 60 - 16

Yopal - Casanare



Ingresa a nuestras redes sociales dando clic en el icono